

Spurenkommission

Gemeinsame Kommission rechtsmedizinischer und
kriminaltechnischer Institute

Bescheinigung

Biotype AG

hat an den Ringversuchen GEDNAP 34 und 35 zur
DNA-Typisierung forensischer Spuren und
Vergleichsproben im Jahre 2007 teilgenommen.

Die Ringversuche umfassten die PCR-Systeme TH01, VWA,
FGA, D21S11, ACTBP2, D3S1358, D8S1179, D18S51,
Amelogenin, DYS19, DYS385, DYS389 I, DYS389 II,
DYS390, DYS391, DYS392 und DYS393.


Sämtliche Proben wurden erfolgreich untersucht mit den
Systemen:

TH01	DYS19
VWA	DYS385
FGA	DYS389 I
D21S11	DYS389 II
ACTBP2	DYS390
D3S1358	DYS391
D8S1179	DYS392
D18S51	DYS393
Amelogenin	

Münster, 31.03.2008



Prof. Dr. med. B. Brinkmann
(Vorsitzender der Spurenkommission)

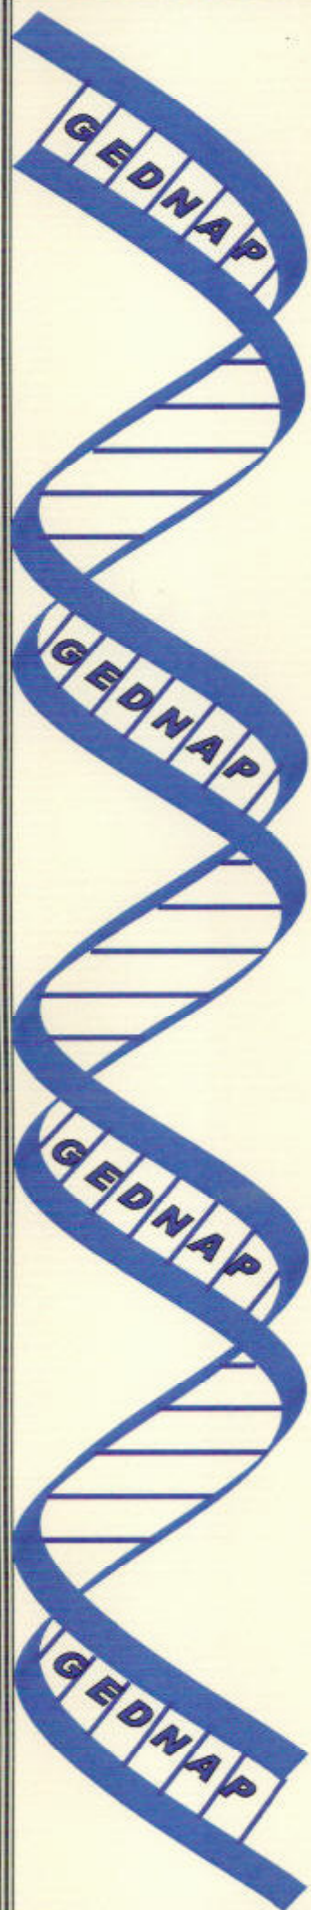

Bescheinigung

Biotype AG

hat im Rahmen des Ringversuchs
GEDNAP 34 die Mischspuren-Auswertung
für Spur 3 nach den Empfehlungen der
Spurenkommission korrekt durchgeführt.

Münster, 07.04.2008



Prof. Dr. med. B. Brinkmann
(Vorsitzender der Spurenkommission)

